



新カラーコード（注射針認証基準等制定）対応タイムスケジュール（案）

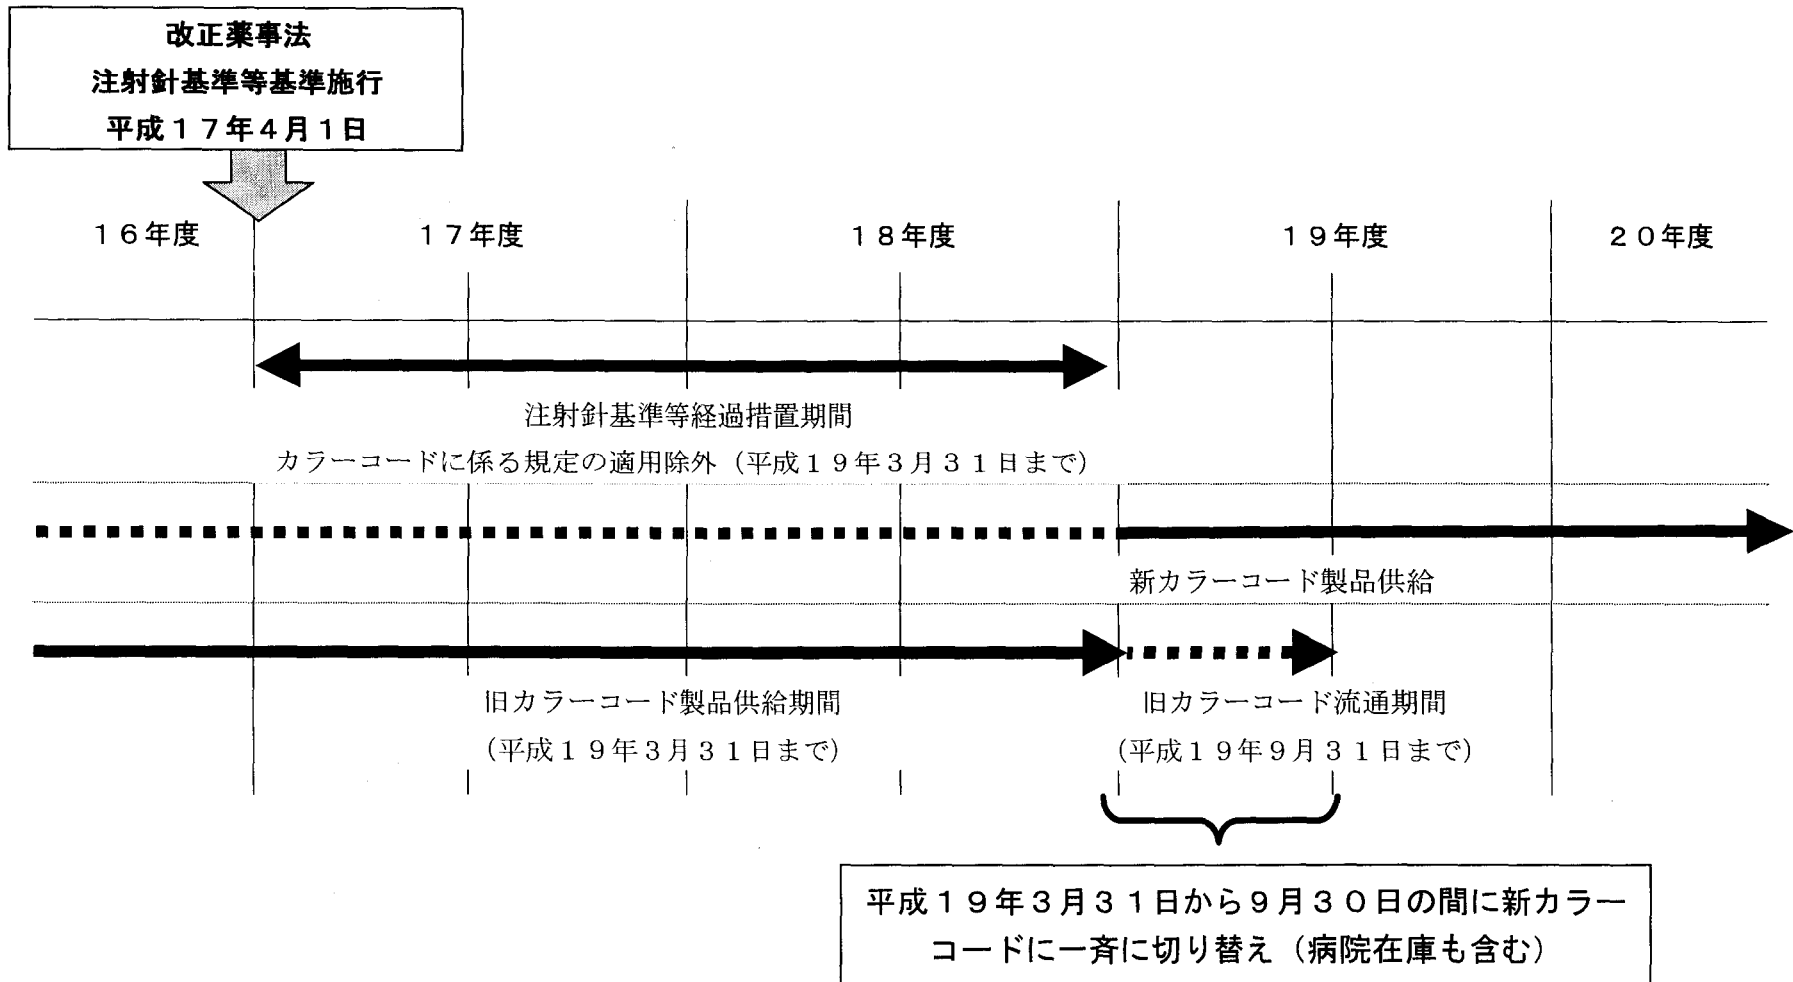

(※) 平成19年3月31日までの2年間、新カラーコードに対する周知期間及び医療機器製造（販売）業者の準備期間とする。

輸液ポンプ・輸液セット適合性認証基準制定及び輸液ポンプ JIS 改正・輸液セット JIS 制定対応タイムスケジュール (案)

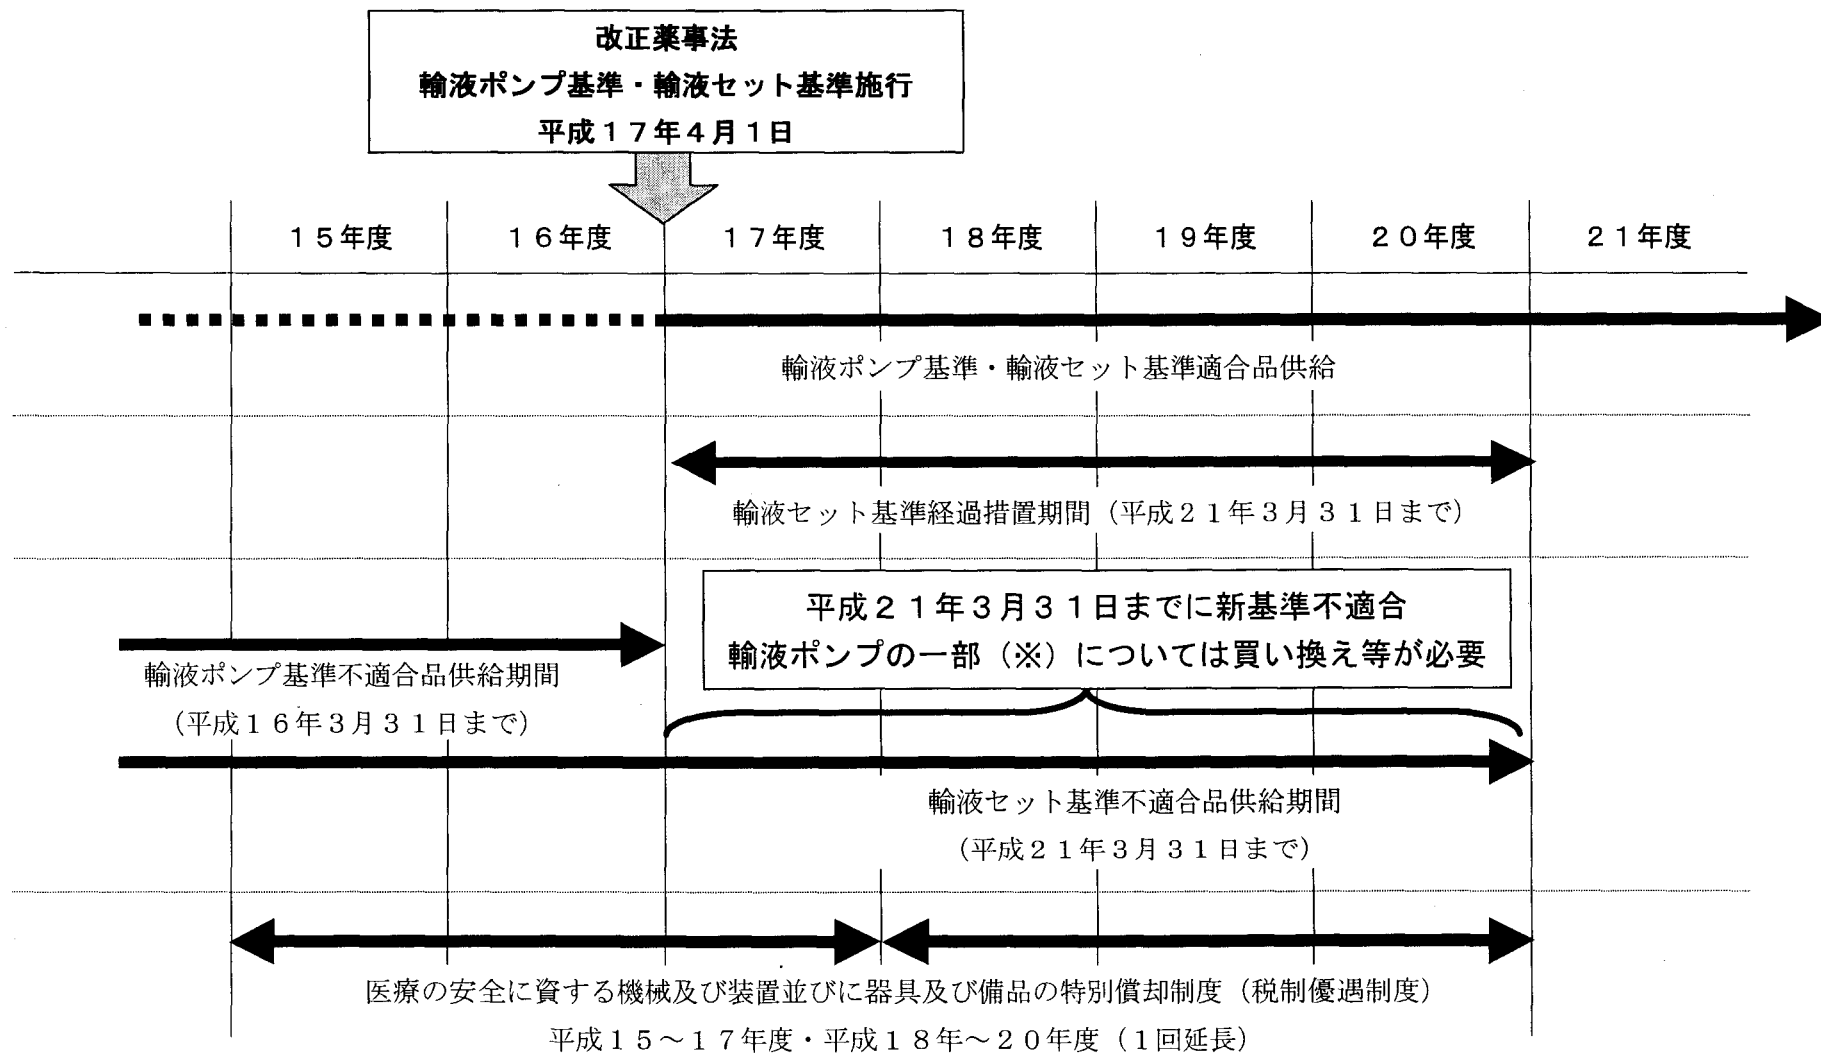

(※) 輸液ポンプ (約40万台) のうち調整・修理が必要なものが約2~3%、買い換えが必要なものが約10%弱存在する。